

平成28年12月14日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

## <<Axygen® 一部製品のラベル仕様変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、Axygenブランドの一部製品について、外箱および内箱/袋のラベル仕様が変わりますのでご案内申し上げます。本変更は、Axygen製品のソルトレイクシティ工場およびレイノッサ工場への製造拠点変更に伴うもので、グローバルでの流通に更に適した仕様となります。











### 変更内容

- ISO認定シンボルの使用 (ISO 15223, EN 980 医療機器シンボル)
- 製造工場名称、製造国、使用期限、ロット番号を単一のラベル上に記載
- カタログ番号およびロット番号のバーコード印字

本変更に伴う製品自体の仕様の変更はありません。

コーニングでは、「先入先出」の在庫管理システムを採用していますので、通常であれば変更前のラベル製品在庫が無くなってから変更ラベル製品の出荷となります。ただし、エアなどの輸送を使用する場合等においては新旧ラベル製品の出荷が前後する場合がございますので予めご了承ください。

変更後ラベルに記載のシンボル見本

	Manufacturer		Sterilized using irradiation		Batch code
	Do not re-use		Keep dry		Catalog Number
	Use by YYYY-MM-DD or YYYY-MM		Fragile, handle with care		Non-pyrogenic
	This way up				

変更前のパッケージラベルフォーマット見本




変更後のパッケージラベルフォーマット見本




© 2016 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社  
 〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階  
 電話番号: 03-3586-1996(代)

変更前のパッケージラベルフォーマット見本

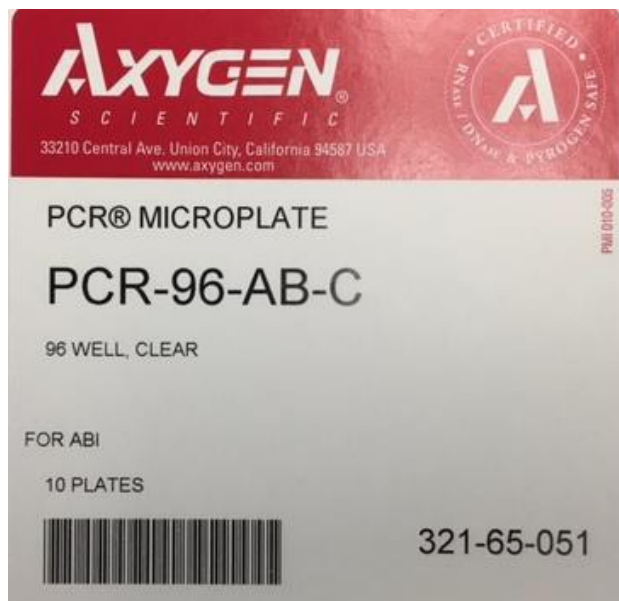


変更後のパッケージラベルフォーマット見本

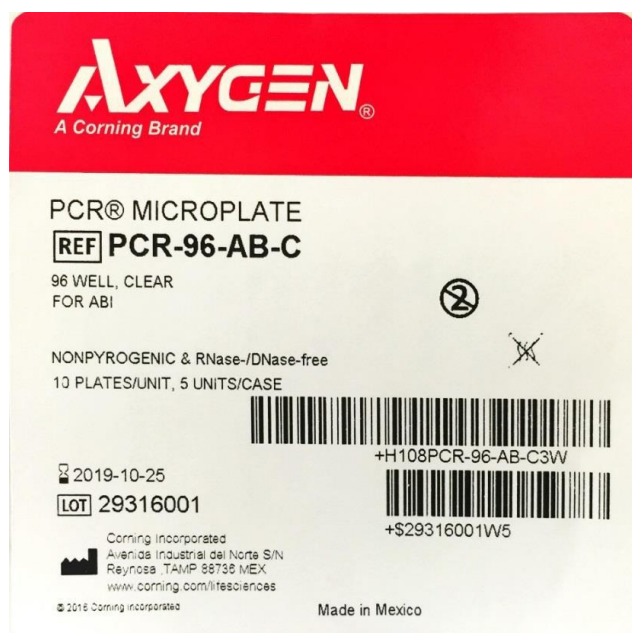

© 2016 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階  
電話番号: 03-3586-1996(代)

変更前のケースラベルフォーマット見本

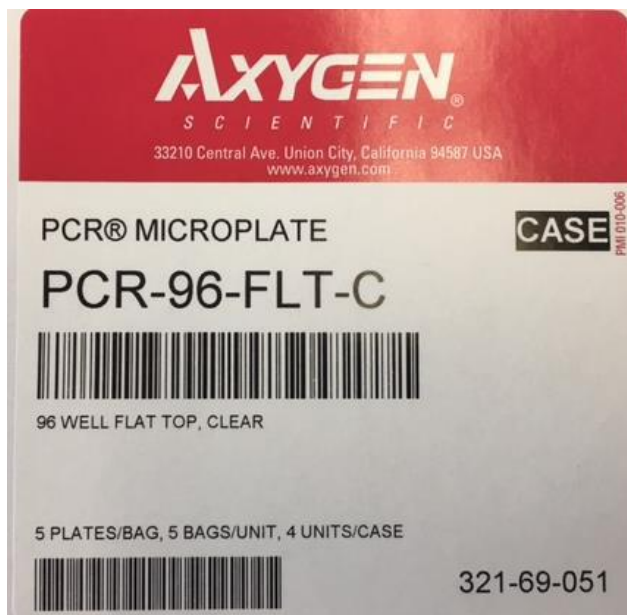

変更後のケースラベルフォーマット見本



© 2016 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階  
電話番号: 03-3586-1996(代)