

2018年6月18日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
 ライフサイエンス事業部

## Corning® および Costar® 細胞培養用マルチウェルプレート ラベル変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning および Costar 細胞培養用マルチウェルプレートの個別包装ラベルの記載内容が、一部の製品で下記の通り変更となりますことをご案内申し上げます。


本変更は、現在のコーニングの基準を満たすラベルにすることを目的としたものです。本変更に伴う製品自体の仕様の変更はありません。

敬具

記

### 変更点

(図)

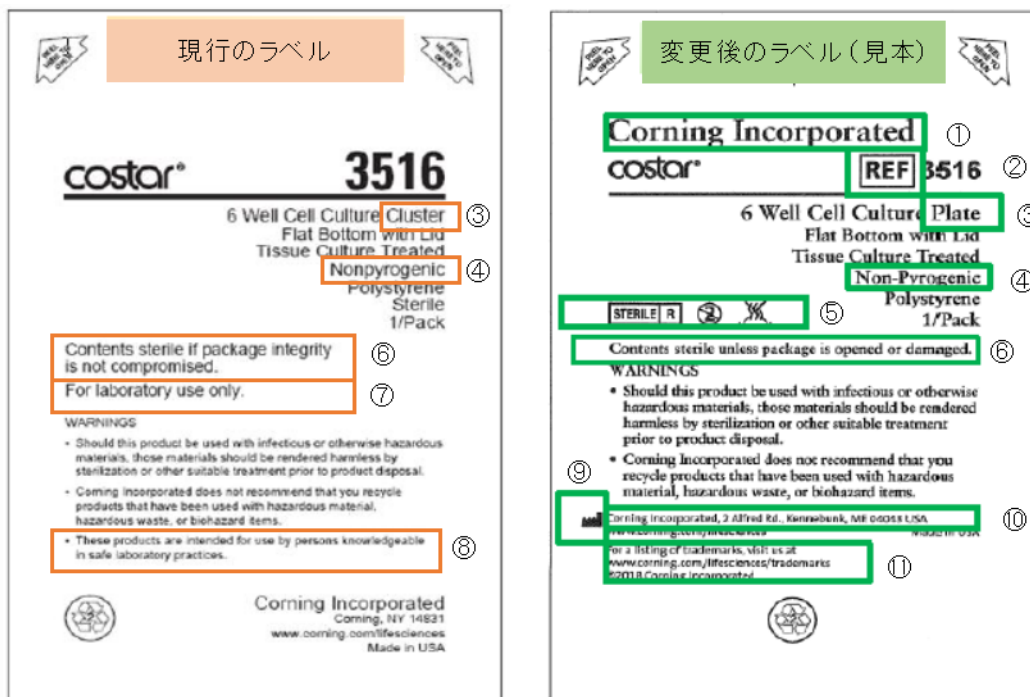

- ① Costar の上部に”Corning Incorporated” を追加
- ② 製品番号の前にREFマークを追加
- ③ “Cell Culture Cluster” から“Cell Culture Plate” に表記を変更
- ④ “Nonpyrogenic” から”Non-Pyrogenic” に表記を変更
- ⑤ 滅菌マーク/非滅菌マークを製品に応じて追加
- ⑤ 再使用不可マークを追加
- ⑤ ノンパイロジェニックマークを製品に応じて追加
- ⑥ “開封あるいは損傷がない限り滅菌を保持”の旨の文言を変更
- ⑦ “For laboratory use only” の文言を削除
- ⑧ “These products are intended for use by persons knowledgeable in safe laboratory practices.” の文言を削除
- ⑨ 法的製造者 (Legal Manufacturer) マークの追加
- ⑩ 住所の追加
- ⑪ “For a listing of trademarks, visit us at [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks)”および”©2018 Corning Incorporated“の追加

## 対象製品

カタログ番号	製品名
3513	マルチプルウェルプレート 12ウェル平底フタ付(個別)
3516	マルチプルウェルプレート 6ウェル平底フタ付(個別)
3524	マルチプルウェルプレート 24ウェル平底フタ付(個別)
3526	マルチプルウェルプレート 24ウェル平底フタ付(個別)
3548	マルチプルウェルプレート 48ウェル平底フタ付(個別)
3590	EIA/RIAプレート 96ウェル平底 高結合型 非滅菌 フタなし
3595	マルチプルウェルプレート 96ウェル平底フタ付低蒸発構造(個別)
3596	マルチプルウェルプレート 96ウェル平底フタ付(個別)
3599	マルチプルウェルプレート 96ウェル平底フタ付(個別)
3799	マルチプルウェルプレート 96ウェル丸底フタ付(個別)
3879	マルチウェルプレート 96ウェル丸底フタ付ポリプロピレン製(個別)
3894	マルチプルウェルプレート 96ウェルV底フタ付(個別)
3896	ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製 96ウェル V底 滅菌済み フタなし

## 変更時期

2018年8月製造分より変更の予定です。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上